

Pasient

Personnr: 010479-12345
 Navn: Stridor, Broncho
 Fødselsdato: 01.04.1979 - Mann - Europeisk

Undersøkelse 02.09.2005 09:22

Tekniker: Admin, Admin (Default)
 Sensor: Spirare sensor (SPS310), SN: 14643
 Referanse: [GLI] Quanjer. (2012) All ages
 Parameter: Anstrengelse

Medikamenter, ordinær

la β 2-agonist
 Inhal. steroids

Medikamenter, Post BD

β 2-agonist

Eksposering

Røyking

Røyker

Spirometri provokasjon Default

Sammendrag



Total testkvalitet: God (C)

Post BD indikerer reversibel obstruksjon.

Automatisk tolkning

Reversibel obstruksjon kan ha vært tilstede ved pre-test.

	Abs	% Endr	% Pred		
FEV1 Pre-test	3,98	0	84	--	C
FEV1 maks.	4,05	1,8	86	02:06	B
FEV1 min.	3,56	10,6	76	13:31	B
FEV1 maks. endr.	--	12,3	(10,4)	--	--
FEV1 Post BD 1	4,29	20,5	91	--	A

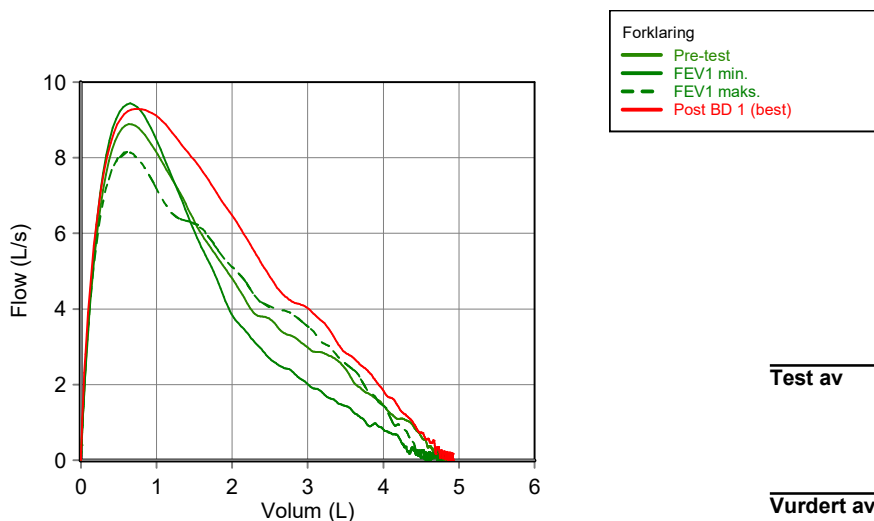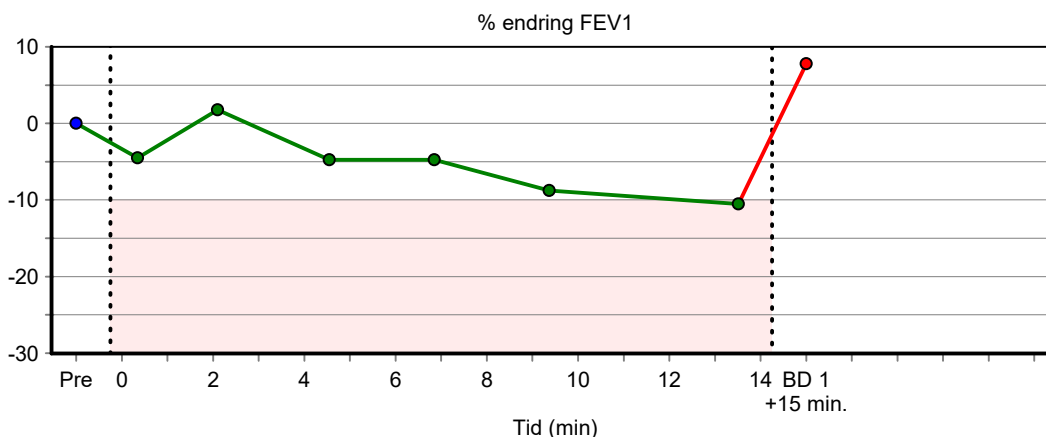

Test av _____

Vurdert av _____

Pasient

Personnr: 010479-12345
Navn: Stridor, Broncho
Fødselsdato: 01.04.1979 - Mann - Europeisk

Undersøkelse 02.09.2005 09:22

Tekniker: Admin, Admin (Default)
Sensor: Spirare sensor (SPS310), SN: 14643
Referanse: [GLI] Quanjer. (2012) All ages
Parameter: Anstrengelse
